



2. Le professionnel se désinfecte les mains avant l'échographie et après le retrait des gants




3. La sonde d'échographie est recouverte par une protection posée au moment de l'examen



1. La salle d'examen est propre et le matériel désinfecté



4. Un gel d'échographie stérile unidose est utilisé

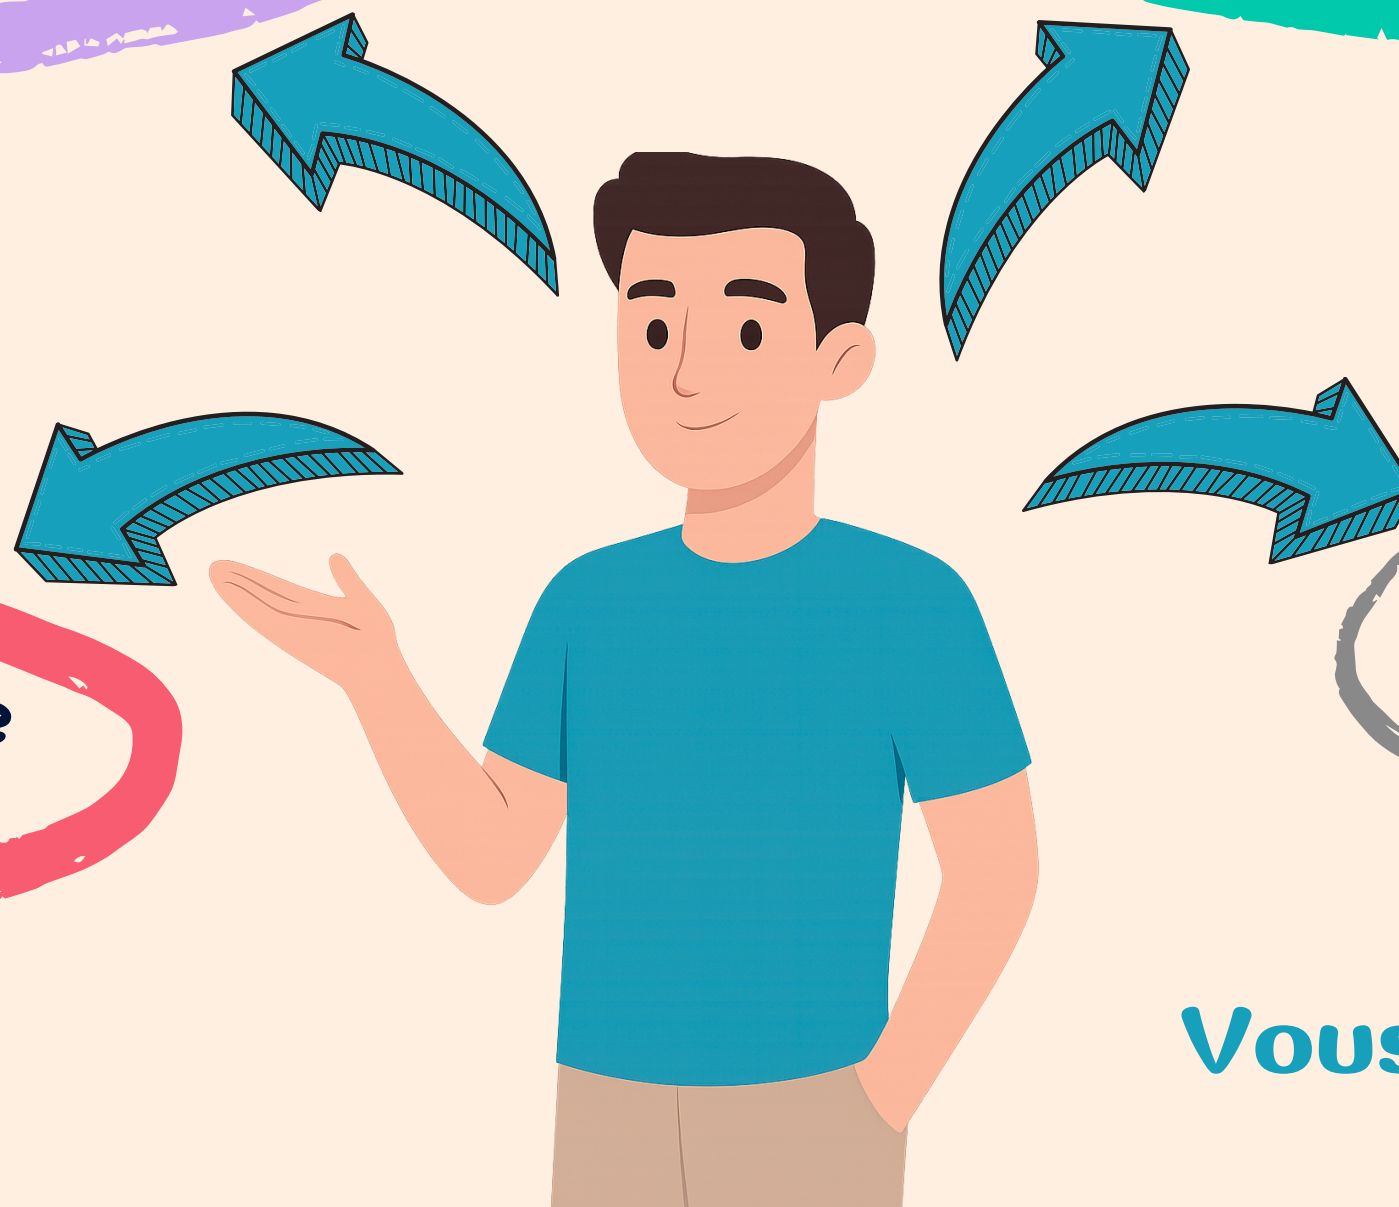

**Vous avez des questions ?
Posez-les !**



ÉCHOGRAPHIE ENDORECTALE PATIENT : LES ESSENTIELS